
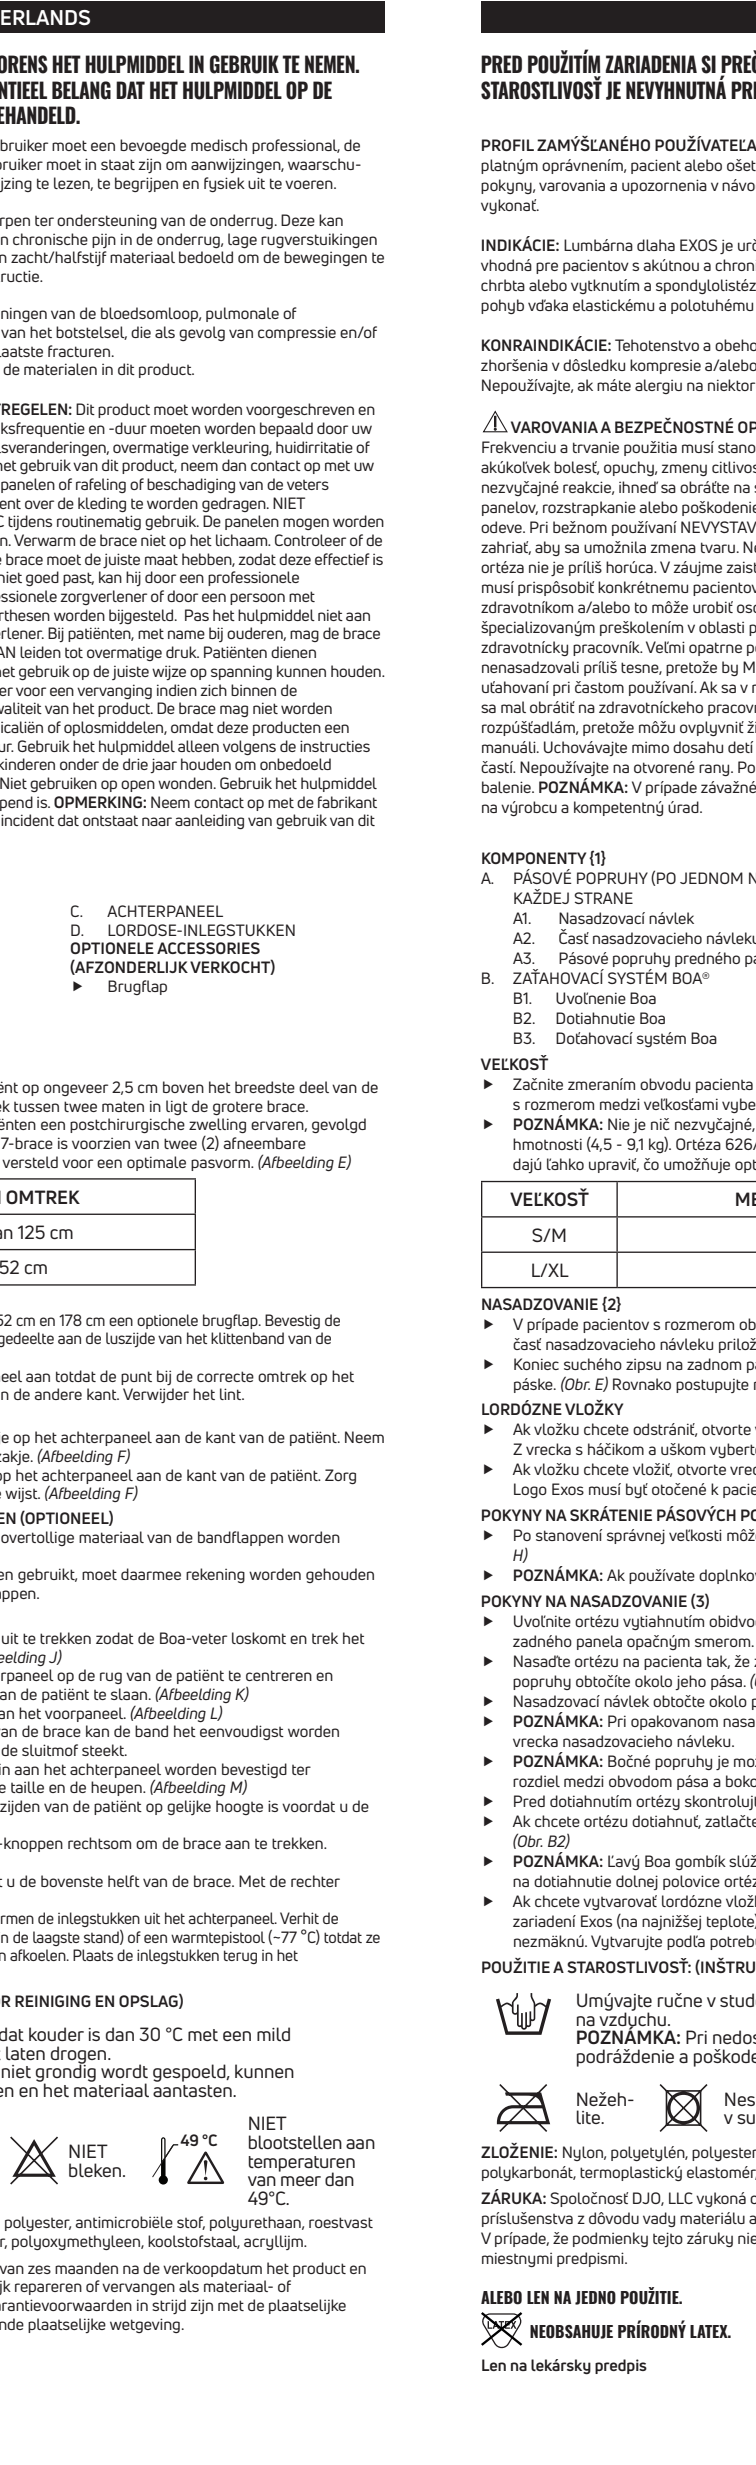
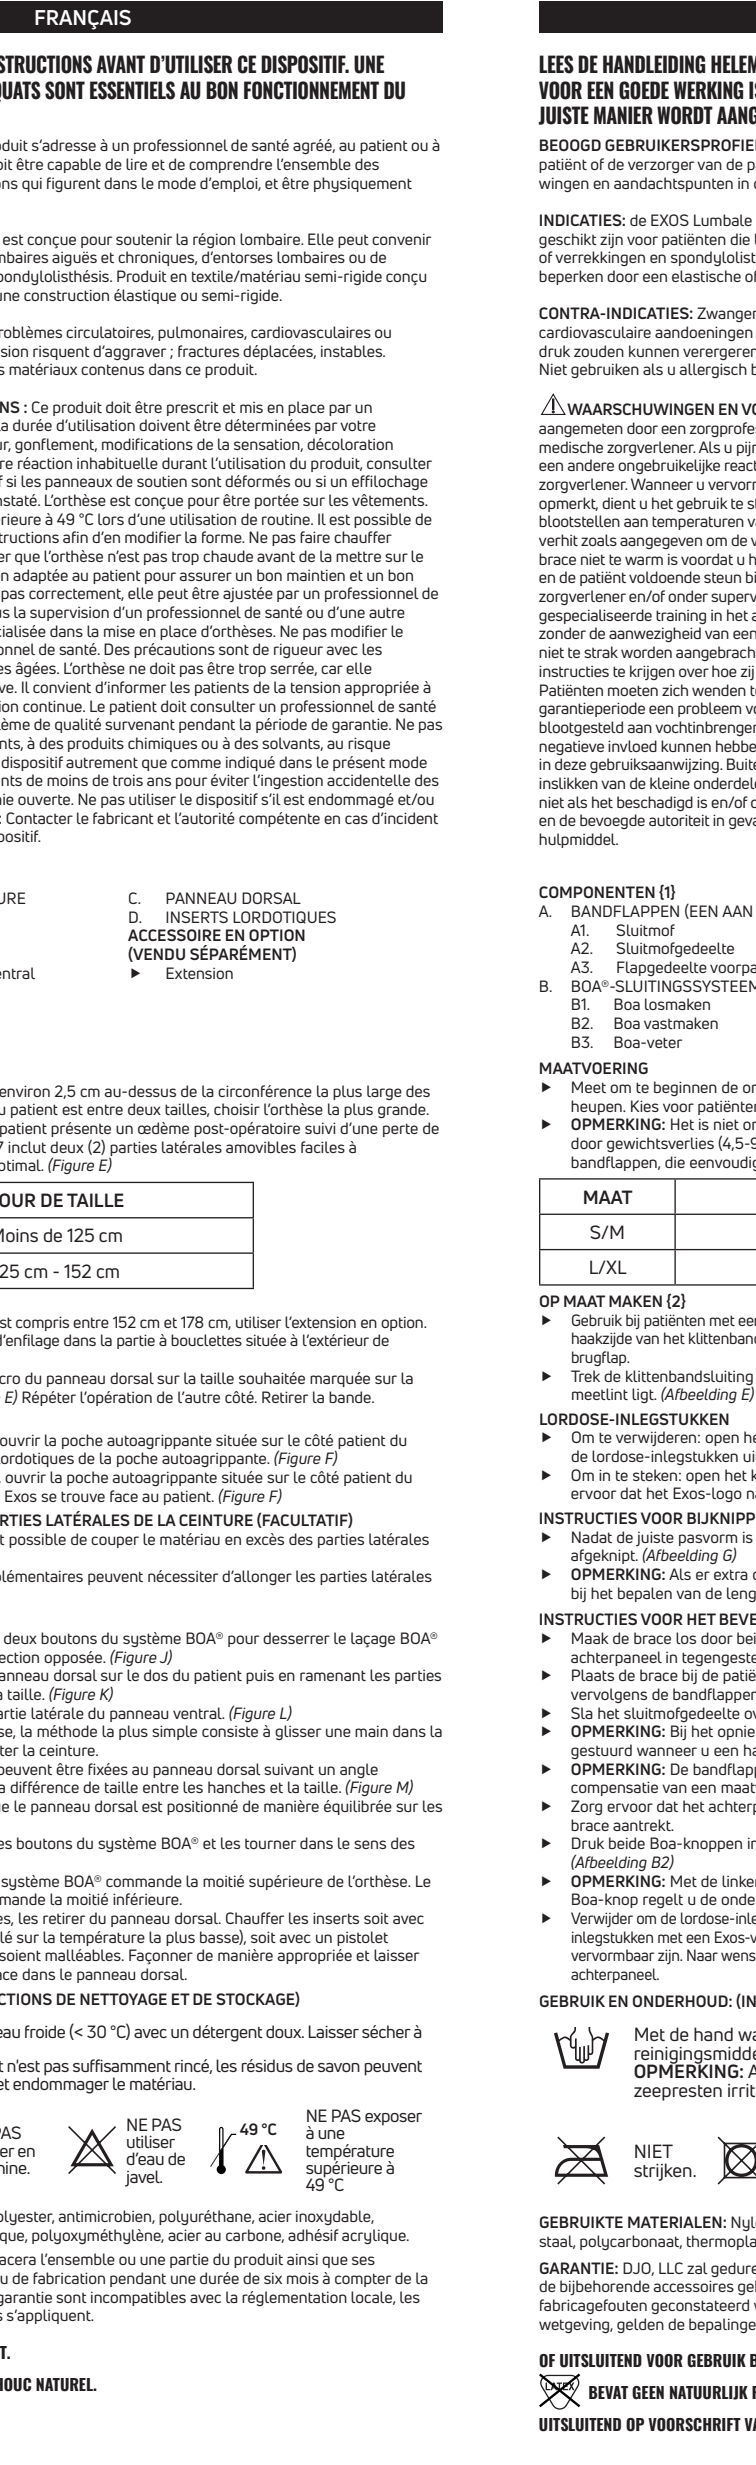
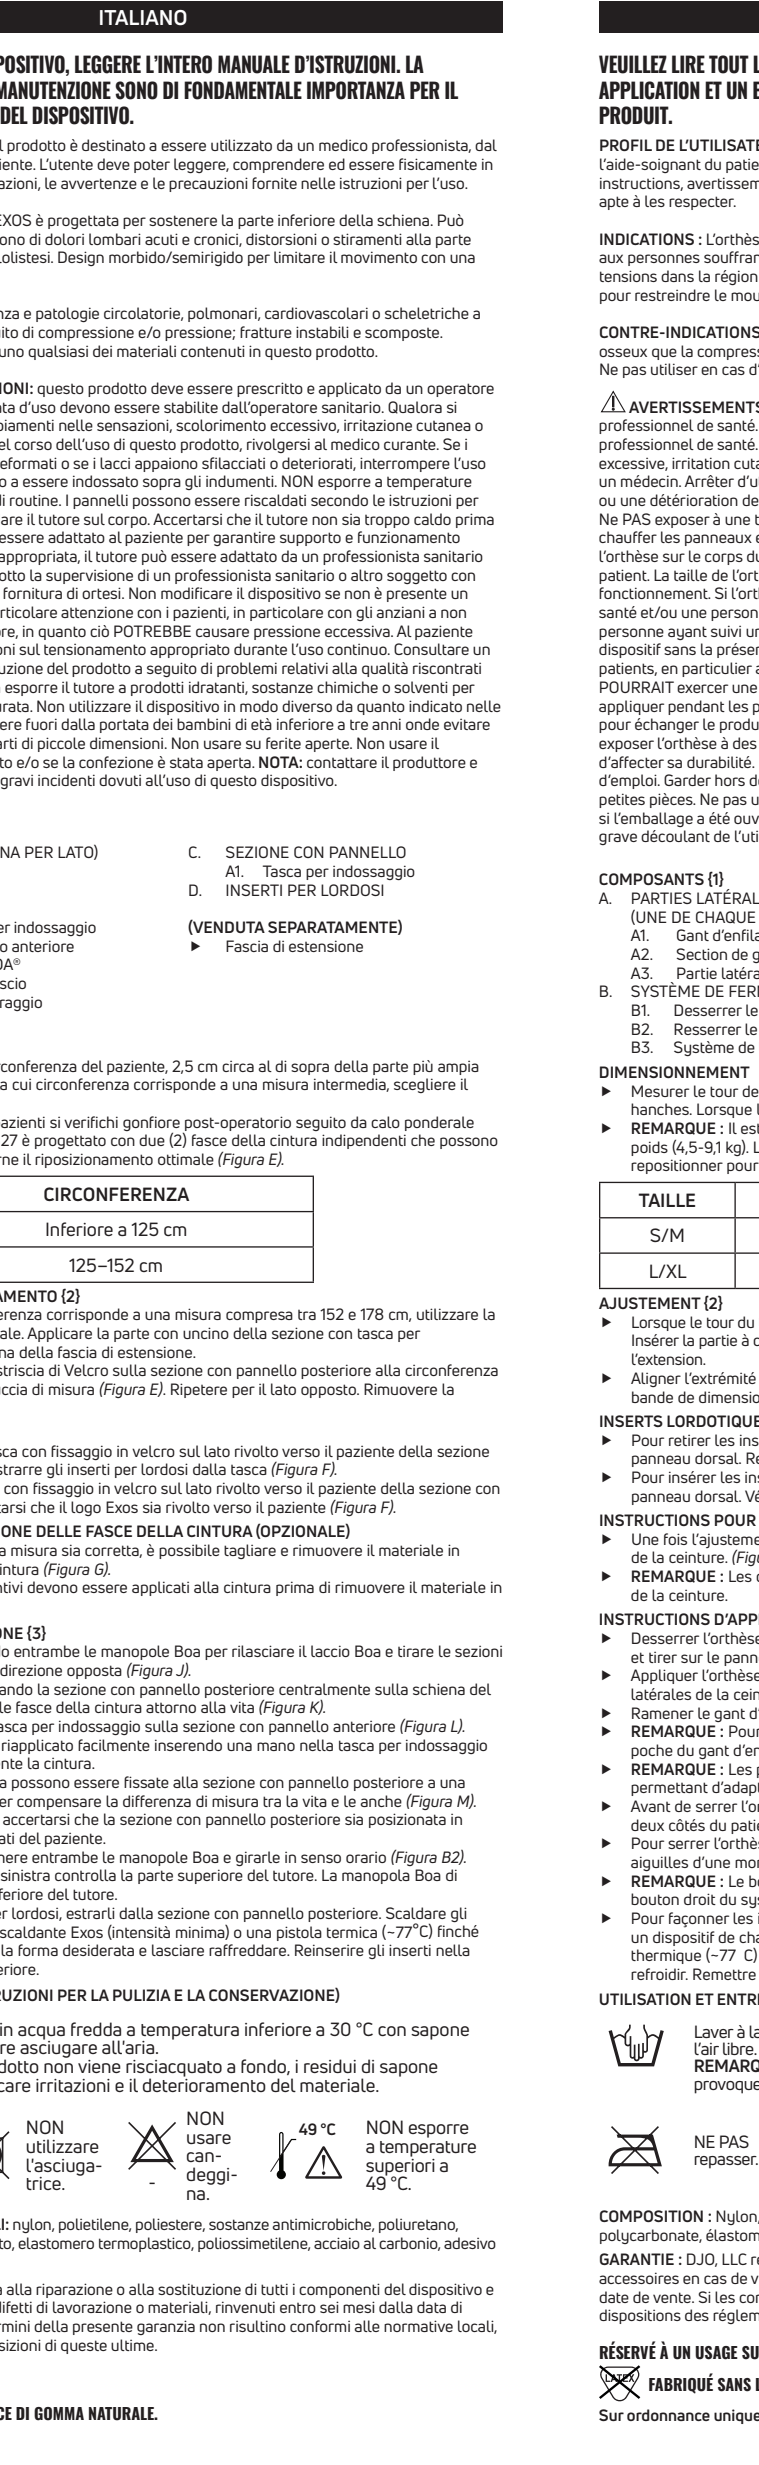
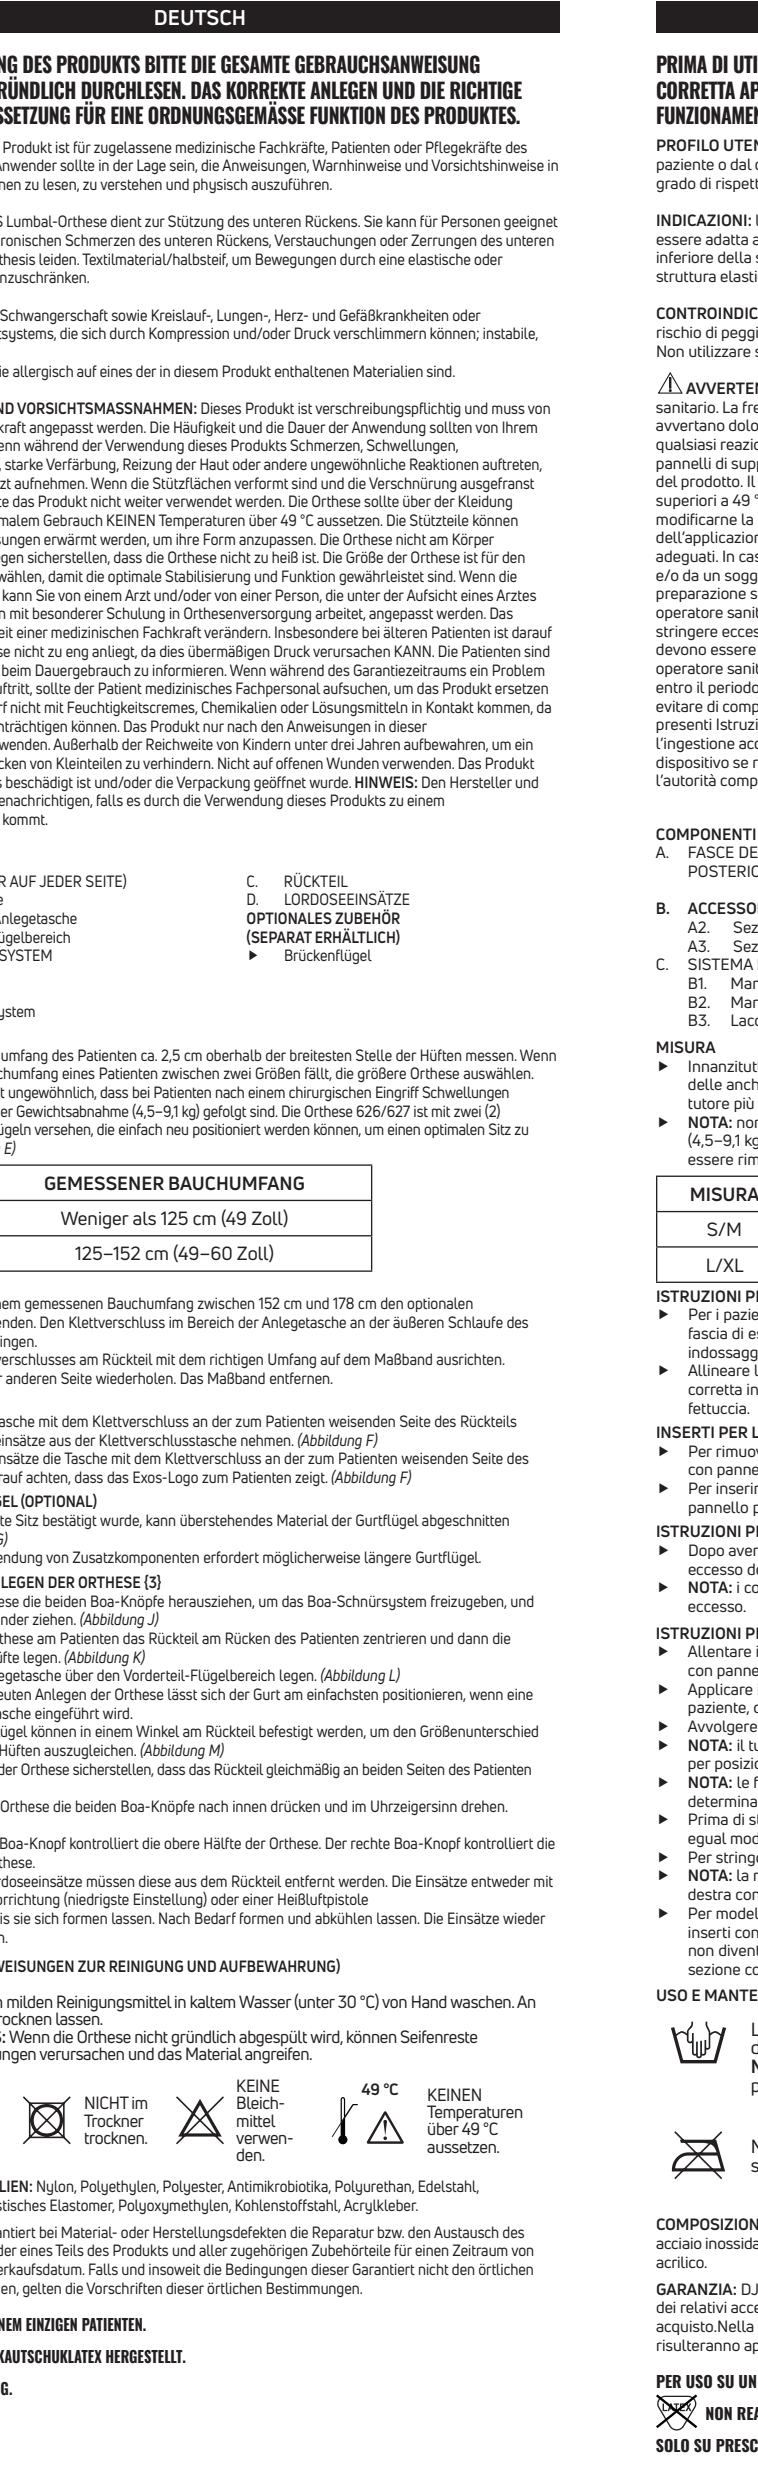
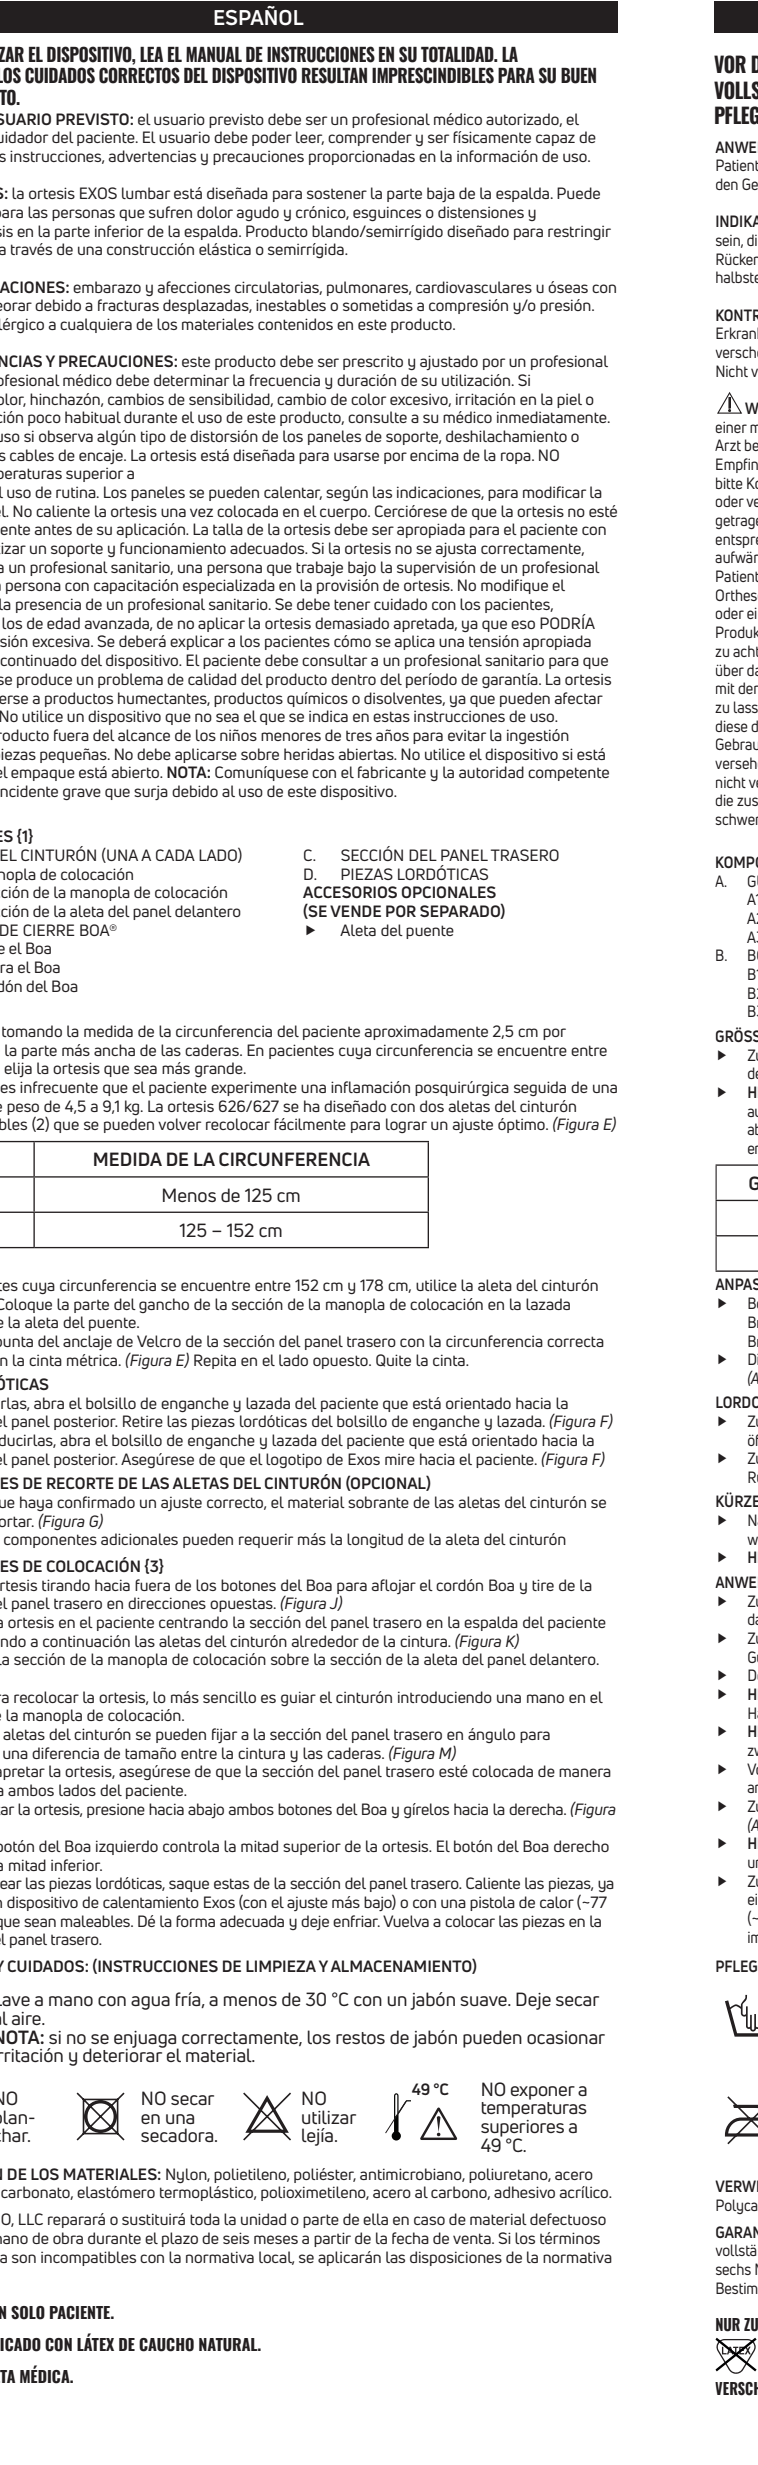
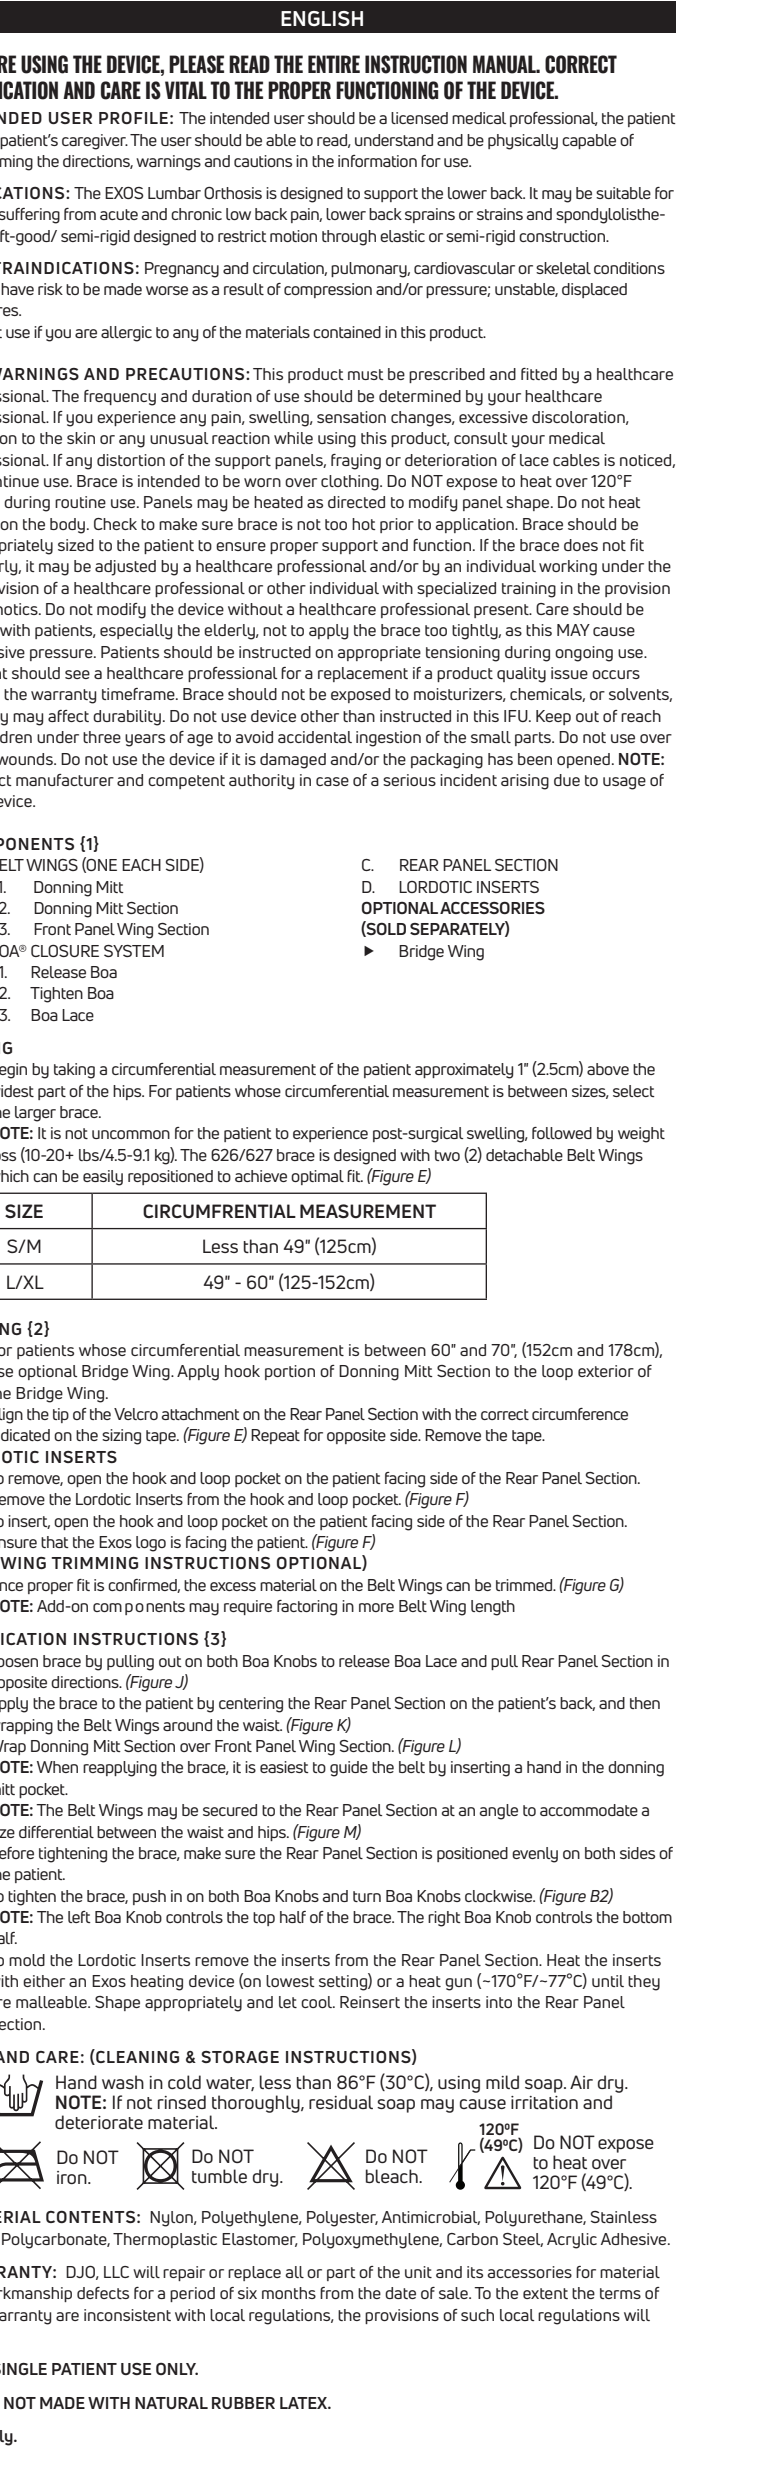
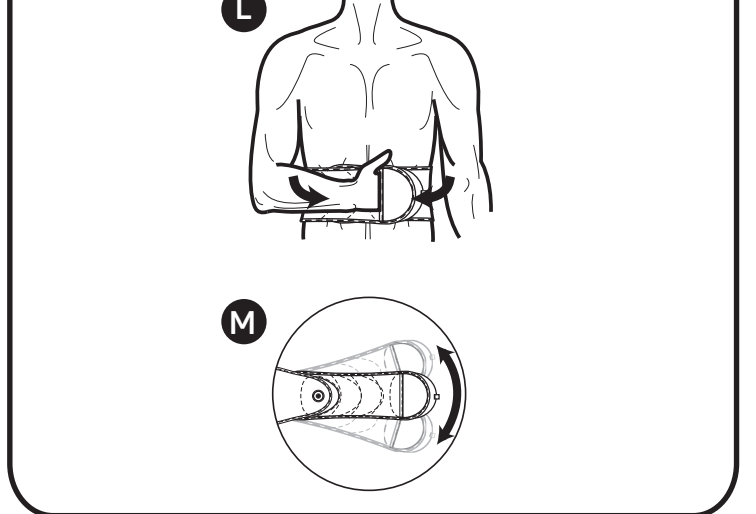
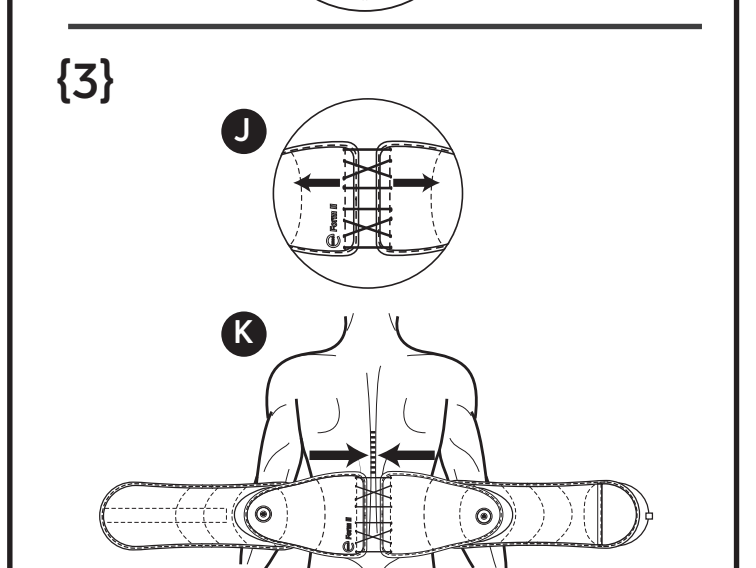
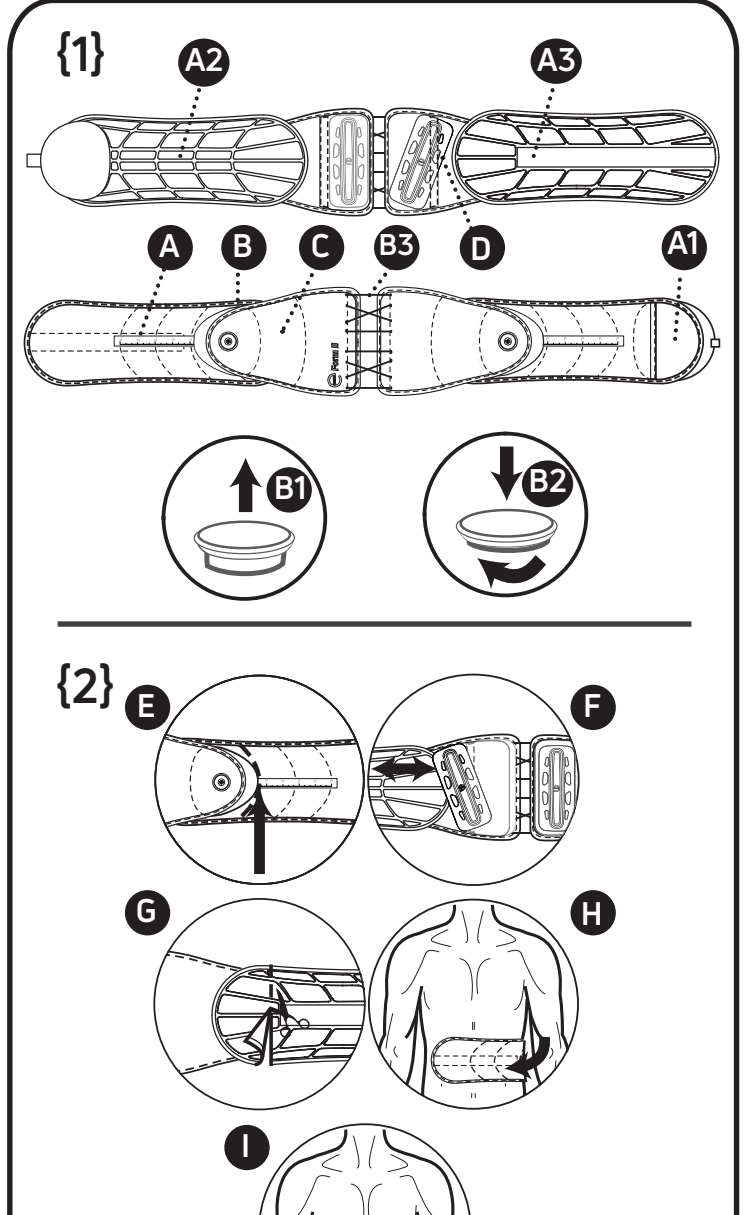


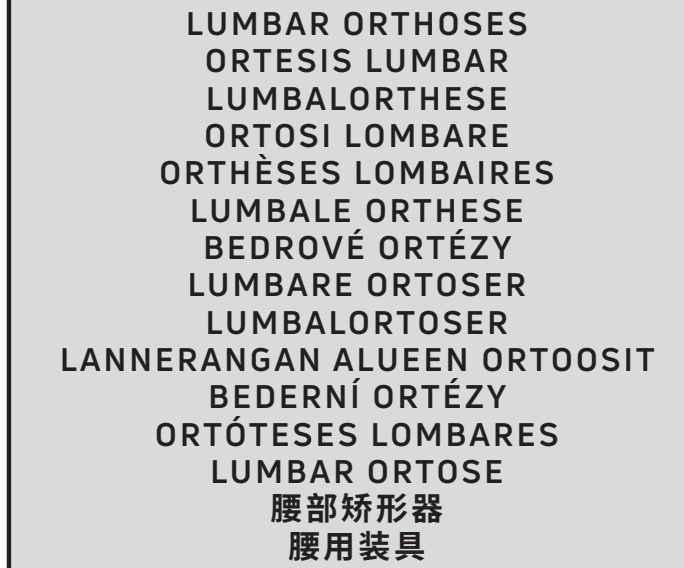

たさい。製品を適切に機能させ
ます。

受けた医療従事者、患者、患者の
報告および注意事項をすべて読

に設計されています。急性および慢性、脊椎すべり症の緩和に適しているように設計されたソフトグッズ/半剛

血液循環、肺疾患、心臓血管、または
しないください。

に、装着されるものです。使用の際の薬品の使用中に疼痛、腫れ、感覚の変化、すぐに医療専門家に相談してください。用を中止してください。ブレースは着49℃より高い温度に加熱しないですることをできます。体に装着したまよいが確認してください。適切なサポーターを使用してください。ブレースがきんの下で働く個人、または器具の提供

合は、過度に圧力がかかるおそれがあります。継続して使用する場合は、必ず製品の品質に関する問題が生じた被害者およびそのため、プレスを保温剤、化学していない方法では装置を使用しない手の届かないところに保管してダメージが損傷している場合は、本装置をリコールが発生した場合は、メーカーにお

後部パネルセクション
前部インサート
サリ(オプション)
ブリッジウイング

の腰回りを測定します。腰回りの長

その後、体重が減少(4.5~9.1 kg)する
アットさせることができる取り外し

ジウイングをお使いください。装着
のループにひっかけます。
ズテープに明記されている正しい
繰り返します。テープを取り外しま

バックとループポケットを開きます。フ
す。(図F)
バックとループポケットを開きま
す。(図F)

の余分な部分を切り取ることがで
ポネントが必要な場合があります

スを取り外して後部パネルセクション
ベルトウイングをウェスト部分に

ベルトウイングを後部パネルセク

計回りに回転させます。(図B2)
す。右側のボアノブは、ブレースの

ン(最高77°C)で、インサートを変
します。インサートを後部パネルセ

いします。空気乾燥させます。
の炎症や製品素材の劣化につ

49°Cより高い
温度に加熱
しないでくだ
さい

また、ホリウレタン、ステンレススチール、メチレン、炭素鋼、アクリル系接

または工作に起因する欠陥につ

2007年12月26日