


Anleitung Genuine Brannock Device

Um die richtige Schuhgröße und Weite zu gewähren, ist es wichtig den Fuß korrekt zu vermessen. Hierfür eignet sich das „Dr. Comifort Brannock Device“, da es nicht nur die Fußlänge, sondern auch die Fußbreite und die Fersen-Ballenlänge misst.

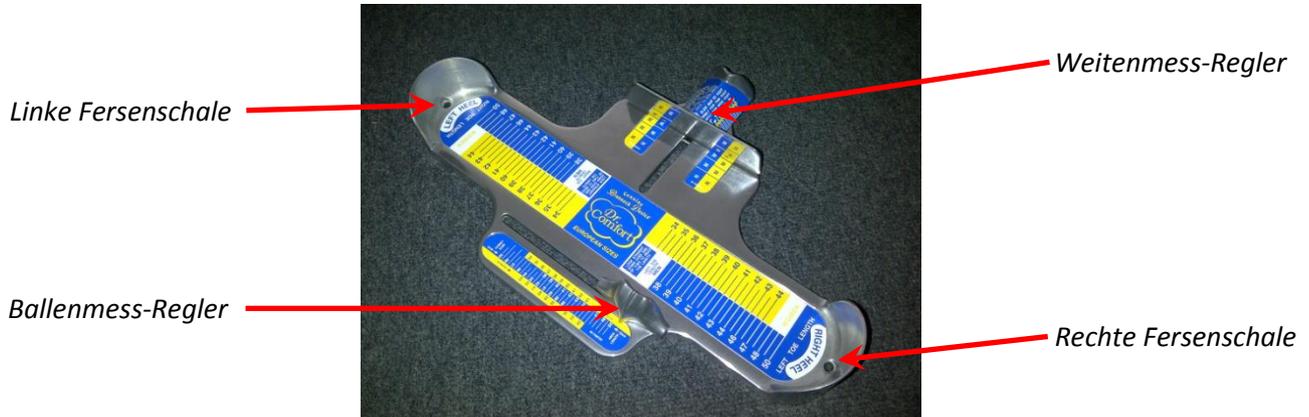

So messen Sie korrekt:

1. Vorbereitung:

- Den Weitenmess-Regler auf die breiteste Position einstellen
- Den Ballenmess-Regler auf Endposition einstellen

2. Fußpositionierung:

- Der Fuß wird im Stehen unter gleichmäßiger Belastung beider Füße gemessen
- Die rechte/linke Ferse in die rechte/linke Fersenschale stellen und prüfen dass diese fest an der Fersenschale ansteht

3. Längenmessung:

- Fersen-Zehen-Länge:
Den längsten Zeh (dies muss nicht der große Zeh sein) nach unten drücken und mit senkrechtem Blick auf die Längentabelle die Größe ablesen (gelb: Damen, blau: Herren).
- Fersen-Ballen-Länge:
Den Ballenmess-Regler auf die Position des Großzehenballens schieben, bis der Ballen sich gut in die Form des Ballenmess-Reglers legt und die entsprechende Schuhgröße auf der kleinen Tabelle ablesen (gelb: Damen, blau: Herren).

4. Korrekte Schuhgröße ermitteln:

- Vergleichen sie die beiden gemessenen Fersen-Zehen-Länge und Fersen-Ballen-Länge.
- Verwenden Sie die größere der beiden gemessenen Längen.

5. Schuhweite ermitteln:

- Schieben Sie den Weitenmess-Regler an die Fußaußenkante.
- Lesen Sie die Fußbreite entsprechend der in Schritt 3 und 4 bereits ermittelten Schuhgröße ab (gelb: Damen, blau: Herren).
- Liegen die Werte zwischen zwei Weiten, wählen Sie eher die kleinere Weite.
- Drücken Sie den Schieber bei einem knöchigen Fuß leicht, bei einem fleischigen Fuß etwas fester an.

6. Messen Sie die andere Seite:

Es ist wichtig beide Füße zu messen. Kleine Unterschiede zwischen den beiden Füßen sind normal. Bei größeren Abweichungen können Sie die Schuhe unpaarig bestellen.